



## CIMSE S.R.L.

Lote 8, Manzana "C", B° San Cristobal, Valentina Sur-Neuquén  
Cel.: Admin. (299) 156-066112; Ger. (299) 155-711354; Lab. (299) 155-179547  
E-mail: administracion@cimsesrl.com.ar; www.cimsesrl.com.ar

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CCI-064-24**

Este certificado de calibración fue emitido de conformidad con los requisitos establecidos en la norma **ISO/IEC 17025** y documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite.

Certificados de calibración sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

**Objeto:** Registrador de temperatura y humedad

**Fabricante:** EXTECH

**Modelo:** 42270

**Número de serie / Identificación:** REG-TH2 - 1019604

**Determinaciones requeridas:** Calibración

**Fecha de calibración:** 13/09/2024

**Fecha de próxima calibración:** 13/09/2025

**Fecha de emisión del certificado:** 20/09/2024

**Número de páginas del certificado y de los anexos:** 4

**Cliente:** CIMSE SRL

**Domicilio:** B° San Cristóbal - Valentina Sur - Lote 8 - Mza "C" - Provincia del Neuquén





## CIMSE S.R.L.

Lote 8, Manzana "C", B° San Cristobal, Valentina Sur-Neuquén  
Cel.: Admin. (299) 156-066112; Ger. (299) 155-711354; Lab. (299) 155-179547  
E-mail: administracion@cimsesrl.com.ar; www.cimsesrl.com.ar

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CCI-064-24**

### 1 - Detalle del objeto a calibrar:

#### ESCALA DE TEMPERATURA:

Rango del instrumento (sensor externo): 

-40	a	85	°C
-----	---	----	----

Menor División: 

0,1	°C
-----	----

Rango calibrado: 

9	a	39	°C
---	---	----	----

#### ESCALA DE HUMEDAD RELATIVA:

Rango del instrumento: 

0	a	99	%RH
---	---	----	-----

Menor División: 

0,1	%RH
-----	-----

Rango calibrado: 


30	a	99	%RH
----	---	----	-----

### 2 - Metodología empleada

La calibración fue realizada de acuerdo al procedimiento interno PT-O-004. Ref OIML R 121.

### 3 - Resultados

Valores expresados en °C tal como fue recibido



Temperatura del medio - INICIAL	Temperatura del medio - FINAL	Temperatura del medio - PROMEDIO	Temperatura del instrumento en calibración	Corrección	Incertidumbre $\pm$
8,99	8,99	8,99	8,4	0,59	0,12
21,90	21,59	21,74	22,0	-0,26	0,95
39,10	39,10	39,10	39,3	-0,20	0,12

La temperatura del medio en la que se compara el termómetro en calibración, es la indicada por el instrumento empleado como patrón de medición.






**CIMSE S.R.L.**

Lote 8, Manzana "C", B° San Cristobal, Valentina Sur-Neuquén  
 Cel.: Admin. (299) 156-066112; Ger. (299) 155-711354; Lab. (299) 155-179547  
 E-mail: administracion@cimsesrl.com.ar; www.cimsesrl.com.ar

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CCI-064-24**

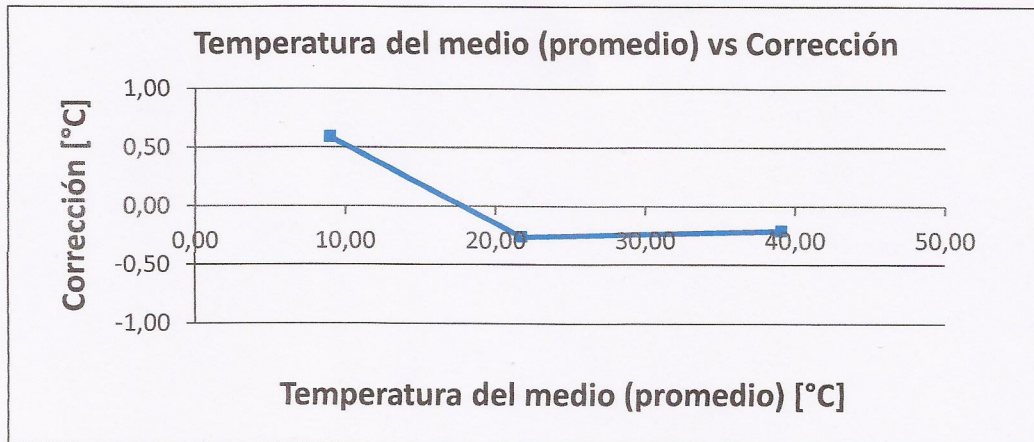

**Escala de humedad valores indicados en % HR**

Humedad relativa del medio [% HR]	Humedad relativa indicada [% HR]	Desviación [% HR]	Temperatura del medio medida en °C
34,6	30,3	-4,3	22,0
71,0	66,6	-4,4	20,1
90,8	87,3	-3,5	20,4

Temperatura ambiente durante la calibración: 22,7 °C

Humedad relativa ambiente durante la calibración: 23,4 %

**Cálculos estadísticos**

Promedio	Desvio estándar	Incertidumbre
$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$	$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$	$It = t * \sqrt{S^2 + I_d^2 + \left(\frac{I_p}{2}\right)^2}$

Dónde:

$\bar{X}$ : Media aritmética de las mediciones

$X_i$ : Valor de la medición

$n$ : Número de mediciones

$t$ : Variable del t- Student igual a 4,303 con un nivel de confianza del 95 %

$S$ : Desviación estándar.

$I_d$ : Incertidumbre atribuible a la menor división.

$I_p$ : Incertidumbre del Patrón.

$I_t$ : Incertidumbre total y expandida.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. La empresa no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.





## CIMSE S.R.L.

Lote 8, Manzana "C", B° San Cristobal, Valentina Sur-Neuquén  
Cel.: Admin. (299) 156-066112; Ger. (299) 155-711354; Lab. (299) 155-179547  
E-mail: administracion@cimsesrl.com.ar; www.cimsesrl.com.ar

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CCI-064-24**

La incertidumbre de medición fue estimada en función de la repetibilidad del instrumento en calibración para un intervalo de confianza aproximado del 95 % que para tres mediciones realizadas se corresponde con un factor de cubrimiento  $t= 4,303$  para una distribución t-Student.



### 4 - Patrones utilizados

Instrumento	Identificación	Certificado	Vencimiento	Código
Monitor de ambiente	TPH-01	2023-002035-1 / 68489	28/09/2024	CCI-061-23
Termorresistencia	TR-05	CCI-034-24	21/05/2025	CCI-034-24
Multímetro	MU-06	216-5937 Único	04/03/2025	CCI-015-24
Termohigrómetro	TMH-01	CCI-014-24	05/04/2025	CCI-014-24

Los certificados de calibración de los patrones utilizados están disponibles para su descarga desde nuestra página web: [www.cimsesrl.com.ar/trazabilidad/](http://www.cimsesrl.com.ar/trazabilidad/), ingresando el código correspondiente indicado en la tabla anterior.

### 5 - Observaciones

1- Sin observaciones.

 <b>Calibrado por:</b> Juan Bravo. Técnico de Laboratorio	 <b>Controlado por:</b> Eduardo Arrausi. Director Técnico
--	--